

## 人Synaptophysin双抗夹心ELISA检测试剂盒

请在实验前仔细阅读本说明书

产品货号: KE00381  
规格: 96T  
灵敏度: 0.01 ng/mL  
检测范围: 0.313-20 ng/mL  
用途: 此试剂盒用于定量检测血清, 血浆以及细胞裂解液中的人Synaptophysin浓度

本产品仅用于科学研究, 不适用于临床诊断

# 目录

一：背景信息	3
二：检测原理	3
三：需自备的实验器材	3
四：试剂盒组分及储存	4
五：实验注意事项	4
六：样本准备	4
七：试剂准备	5
八：实验步骤	6
九：实验参数	7
9.1 参考标曲图	7
9.2 精密度	7
9.3 加标回收率	8
9.4 样本值	8
9.5 灵敏度	8
9.6 线性	9
9.7 特异性	9
十：参考文献	9

## 一：背景信息

突触素 (SYP, 也称为主要突触囊泡蛋白 p38) 是一种 38 kDa 的整合膜糖蛋白, 可调节突触囊泡内吞作用。按质量计算, 它是最丰富的突触囊泡蛋白。突触素存在于参与突触传递的神经内分泌细胞和神经元中。阿尔茨海默病患者的脑组织中突触蛋白 (包括突触素) 减少。突触素是识别神经内分泌细胞和肿瘤的有力标记。

## 二：检测原理



### ◀双抗夹心模式图 (检测抗体直标HRP)

按操作顺序形成抗体夹心结构后, 加入TMB底物, 板孔液体由无色变成蓝色, 再加入终止液液体变为黄色后进行吸光度值测定。

## 三：需自备的实验器材

- 3.1 酶标仪 (可读取450 nm和630 nm双波长);
- 3.2 高精度移液器及一次性移液器枪头;
- 3.3 洗板机 (亦可手动洗板);
- 3.4 EP管 (用于稀释标准品及样本);
- 3.5 吸水毛巾或滤纸 (用于拍干);
- 3.6 烧杯和量筒;
- 3.7 用于ELISA实验的数据分析的统计拟合软件 (推荐四参数拟合方法), 如: Origin, ELISA Calc等。

## 四：试剂盒组分及储存

英文名称	中文名称	规格	数量
Microplate	预包被酶标板 - 96 孔板	8孔 × 12条	1 块
Protein standard	标准品 - 冻干粉状 *	40 ng/瓶	2 瓶
Detection antibody, HRP-conjugated (100×)	HRP标记检测抗体浓缩液 (100×) **	120 μL/支	1 支
Sample Diluent PT 4B1	样本稀释液 PT 4B1 (用于细胞裂解液样本)	30 mL/瓶	1 瓶
Sample Diluent PT 3-ef	样本稀释液 PT 3-ef (用于人血清和血浆样本)	30 mL/瓶	1 瓶
Detection Diluent	抗体稀释液	30 mL/瓶	1 瓶
Wash Buffer Concentrate (20×)	浓缩洗涤液 (20×)	30 mL/瓶	1 瓶
Extraction Reagent	裂解液	30 mL/瓶	1 瓶
Tetramethylbenzidine Substrate (TMB)	显色底物 TMB	12 mL/瓶	1 瓶
Stop Solution	终止液	12 mL/瓶	1 瓶
Plate Cover Seals	封板膜		4 张

**储存条件：**  
1：未开启试剂盒可在2-8℃条件下存放6个月或者在-20℃条件下存放1年  
2：已开启试剂盒可在2-8℃存放7天  
3：每次实验均使用新的标准品,使用后丢弃

\* 使用对应的样本稀释液对标准品进行复溶，复溶过程避免产生气泡

\*\* 开盖前请离心

## 五：实验注意事项

- 5.1 避免皮肤接触终止液以及TMB 显色液；
- 5.2 在实验过程中，注意穿戴个人防护装备，如实验服，手套，口罩和护目镜；
- 5.3 请勿将不同批次的试剂进行混用，过期产品请勿使用；
- 5.4 在使用自动洗板机时，板孔加入洗涤液之后，设置30秒的浸泡程序，以提高分析的精确度。

## 六：样本准备

- 6.1 血清：全血标本室温凝固 30 min后1000×g 离心15 min，取上清立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。
- 6.2 血浆：可用EDTA、肝素或柠檬酸盐作为抗凝剂，标本采集后1000×g 离心15 min，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融（注意：标本溶血会影响检测结果，因此溶血标本不宜进行检测）。
- 6.3 细胞裂解液：收集细胞后，用预冷(2-8℃)的1×PBS洗3次，500×g离心5 min。细胞计数，离心弃上清；加PMSF至细胞裂解液中，终浓度为1 mM；按每 $1 \times 10^7$ 个细胞，加入1 mL细胞裂解液(含PMSF)，冰上裂解30 min，其间上下颠倒使裂解更充分，超声波破碎处理，8000×g-10000×g离心5 min，分离上清，分装后-80℃存放，并用BCA蛋白浓度测定试剂盒测定总蛋白浓度，避免反复冻融。

## 七：试剂准备

### 7.1 洗涤液 (1×)：

如果洗涤液 (20×) 有晶体析出, 37°C加热至晶体全部溶解。按1:20稀释倍数进行稀释: 如取30 mL 浓缩洗涤液 (20×), 加入570 mL 超纯水或去离子水, 得到洗涤液 (1×)。

### 7.2 HRP标记检测抗体 (1×)：

开盖前瞬时离心, 按1:100比例进行稀释, 稀释前根据预先计算实验所需的总量配制 (100 μL/孔), 实际配制时应多配制0.1-0.2 mL。如10 μL HRP标记检测抗体浓缩液 (100×) 加 990 μL 抗体稀释液进行配制, 轻轻混匀。


### 7.3 待检测样本：

不同的样本使用相应的样本稀释液进行稀释, 如果样本检测值超过标曲最高范围, 可将样本进行一定的稀释后再进行实验, 使样本的检测值处于标曲范围内, 不同样本的稀释倍数需自行优化。

稀释比推荐如下: 人血清和血浆样本1:2稀释; 细胞裂解液样本1:10或1:20稀释; 样品采集、处理和储存的差异可能导致测值的改变。

### 7.4 梯度稀释的标准品：

检测人血清和血浆样本, 用2 mL PT 3-ef样本稀释液复溶标准品; 检测细胞裂解液样本, 用2 mL PT 4B1样本稀释液复溶标准品。具体操作如下:

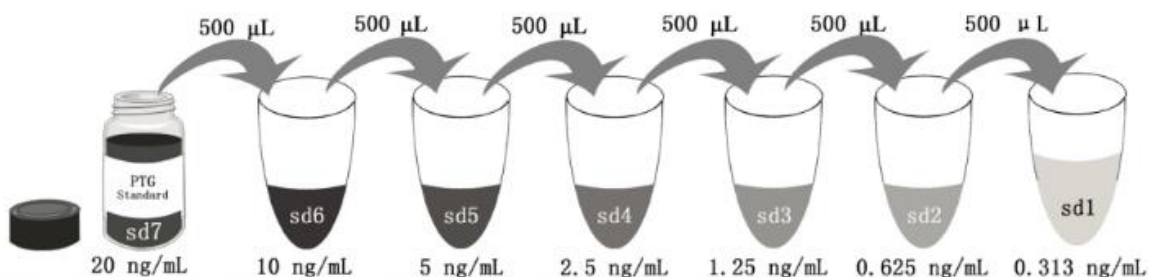

Add # μL of Standard diluted in the previous step	—	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL
# μL of Sample Diluent PT 4B1 or PT 3-ef	<b>2000 μL</b>	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL
	"sd7"	"sd6"	"sd5"	"sd4"	"sd3"	"sd2"	"sd1"

## 八：实验步骤

实验前，需要将所需试剂在室温平衡20-30min（HRP标记检测抗体浓缩液不需要平衡室温，即用即取）；在进行标准品、样本以及不同试剂加样时，更换枪头，避免接触微孔板的内表面，不同的试剂，使用不同的加样槽。

8.1 根据实验用量，取出需要用到的酶标板条，剩余板条加入干燥剂放入铝箔袋密封后存放于4°C，并于一周之内用完；

8.2 加样，分别设零孔、标准孔、待测样本孔。零孔加样本稀释液100 μL，余孔分别加梯度稀释的标准品或待测样本100 μL/孔，注意不要产生气泡（建议标准品和样本都做复孔，尽量避免实验误差，确保上样不间断，5-10 min完成加样）；

8.3 酶标板盖上覆膜，37°C孵育2 h；

8.4 洗涤

1) 揭开封板膜（动作轻柔，避免动作过大导致液体溢出串孔），弃液体，拍干；

2) 洗涤液（1×）洗涤板条，每孔350-400 μL，洗涤后，甩掉液体拍干板条，重复此步骤4次，避免异物进入板孔以及板条干燥；

8.5 每孔加100 μL HRP标记检测抗体（1×）（参照试剂准备部分7.2），盖上封板膜，37°C孵育40 min；

8.6 重复步骤8.4；

8.7 显色：每孔加TMB显色液100 μL，37°C避光显色 15-20 min（如果颜色偏浅，可适当延长显色时间，不超过30 min；保持显色底物始终处于避光状态，显色底物在加样前应是无色透明，如有变色，请勿使用）；

8.8 终止：每孔加终止液100 μL，蓝色变黄色。终止液与TMB显色液的加样顺序一致；（注意：眼睛和皮肤避免接触终止液）

8.9 读数：以630 nm为校正波长，用酶标仪在450 nm波长测量各孔的光密度(OD值)。加入终止液后5 min内进行读数，若无630 nm波长，也可直接使用450 nm 波长读数；


8.10 数据分析：每个标准品和样本的OD值需减去零孔的OD值，设置复孔，取其平均值。以标准品的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，使用专业软件（如Origin、ELISACalc等）进行四参数拟合（4-PL），根据样本的OD值由标准曲线推算出拟合浓度，乘以稀释倍数得到样本的实测浓度。

操作流程如下：


步骤	试剂	体积	孵育时间	洗涤次数	孵育温度
1	标准品或样本	100 μL	120 分钟	4 次	覆膜后37°C孵育
2	HRP标记检测抗体（1×）	100 μL	40 分钟	4 次	覆膜后37°C孵育
3	显色 TMB	100 μL	15-20 分钟	不需要洗涤	覆膜后37°C孵育，避光
4	终止液	100 μL	0 分钟	不需要洗涤	-
5	加入终止液后以630 nm为校正波长，在450 nm处测量OD值，此过程建议不超过5分钟				

## 九：实验参数

### 9.1 参考标曲图

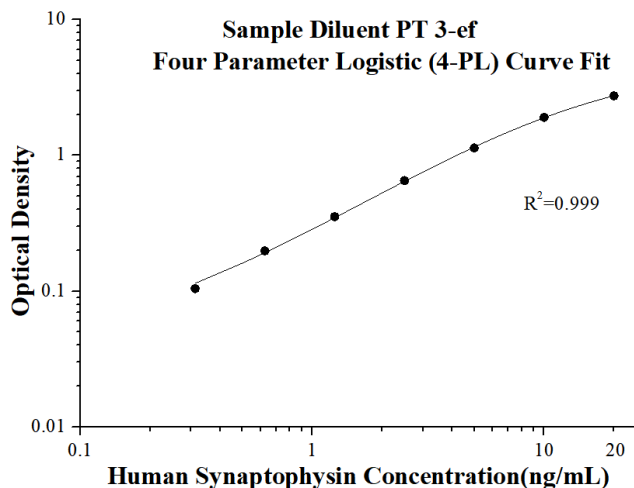

(ng/mL)	O.D	Average	Corrected
0	0.0303 0.0245	0.0274	-
0.313	0.1312 0.1325	0.13185	0.10445
0.625	0.2316 0.2189	0.22525	0.19785
1.25	0.3829 0.3798	0.38135	0.35395
2.5	0.6749 0.683	0.67895	0.65155
5	1.1426 1.1774	1.16	1.1326
10	1.9101 1.9592	1.93465	1.90725
20	2.7695 2.7709	2.7702	2.7428

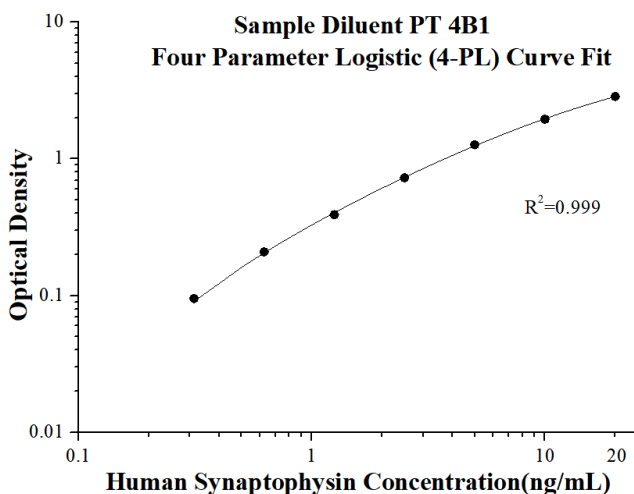

(ng/mL)	O.D	Average	Corrected
0	0.0094 0.0105	0.00995	-
0.313	0.106 0.1045	0.10525	0.0953
0.625	0.2123 0.2258	0.21905	0.2091
1.25	0.3975 0.4043	0.4009	0.39095
2.5	0.741 0.7346	0.7378	0.72785
5	1.2526 1.3102	1.2814	1.27145
10	1.9499 1.9728	1.96135	1.9514
20	2.8631 2.876	2.86955	2.8596

### 9.2 精密度

板内精密度：3个不同浓度的样本在板内重复测定 20次；

板间精密度：3个不同浓度的样本在板间重复测定 24次。

板内精密度 (CV内)				
样本	数量	平均值 (ng/mL)	标准差	变异系数CV%
1	20	8.44	0.22	2.65
2	20	1.98	0.06	2.90
3	20	0.49	0.02	4.35

板间精密度 (CV间)				
样本	数量	平均值 (ng/mL)	标准差	变异系数CV%
1	24	8.85	0.44	5.00
2	24	2.06	0.10	4.77
3	24	0.55	0.03	4.88

### 9.3 加标回收率

样本稀释后，在标曲范围内选择高、中、低3个浓度，进行人Synaptophysin的加标回收率实验，结果如下：

样本类型	稀释倍数	平均值 (%)	范围 (%)
人血清	1:4	104	91-111
细胞裂解液	1:40	95	85-107
	1:80	90	87-94

### 9.4 样本值

人血清 - 应用本试剂盒，检测人血清样本中人Synaptophysin的浓度。

样本类型	平均值 (pg/mL)	范围 (pg/mL)
人血清 (n=16)	642.37	3.02-4982.73

#### 细胞裂解液

	人Synaptophysin (ng/mL)	总蛋白 (mg/mL)
SH-SY5Y细胞裂解液	67.42	2.2

### 9.5 灵敏度

用20个重复的零孔平均OD值加上两倍标准差得到的OD值带入标准曲线拟合出对应的浓度值，此试剂盒中人Synaptophysin的灵敏度为0.01 ng/mL。



## 9.6 线性

用对应样本稀释液稀释样本，使稀释后的检测值处于标曲范围内，线性数据如下：

(细胞裂解液样本预先稀释5倍。)

		人血清 (样本稀释液PT 3-ef)	细胞裂解液 (样本稀释液 PT 4B1)
1:2	均值 (%)	100	100
	范围 (%)	-	-
1:4	均值 (%)	101	100
	范围 (%)	93-109	94-107
1:8	均值 (%)	93	91
	范围 (%)	92-94	87-95
1:16	均值 (%)	106	93
	范围 (%)	96-115	87-99

## 9.7 特异性

本试剂盒特异性识别天然和重组人Synaptophysin。

## 十：参考文献

1. Wiedenmann B. et al. (1986) Proc Natl Acad Sci U S A 83(10):3500-4.
2. Kwon SE. et al. (2011) Neuron 9;70(5):847-54.
3. Goetzl EJ. et al. (2016) FASEB J 30(12):4141-4148.
4. Davidsson P. et al. (1998) Int Psychogeriatr 10(1):11-23.
5. Reddy PH. et al. (2005) J Alzheimers Dis 7(2):103-17; discussion 173-80.